medische laboratoria
medina | cma | lko-lmc | akl

MyUpload

New in MyLab

Eenvoudig afbeeldingen opladen bij uw biopt aanvragen

In de kijker

Ons anatomopathologisch labo behoort tot de meest geavanceerde laboratoria in België. Dagelijks bundelt ons team van 13 anatomopathologen hun expertise in intensieve casusbesprekingen, zodat elke diagnose wordt gedragen door collectieve kennis en ervaring.

Via periodieke ESQ-clubs gaan we in dialoog met artsen en dermatologen rond complexe en leerrijke casussen. Zo bouwen we aan diagnostiek van het hoogste niveau, met maximale klinische relevantie en vertrouwen voor u en uw patiënt.

Inleiding

Ons digitaal laboplatform MyLab wordt door artsen gewaardeerd als één van de meest vooruitstrevende en gebruiksvriendelijke oplossingen in België. Gecreëerd voor en door artsen blijven we MyLab evolueren met een voortdurende focus op een optimale ondersteuning van uw klinische praktijk.

Met diezelfde ambitie lanceren wij MyUpload, een nieuwe functionaliteit waarmee u bij de afname en aanvraag van een biopt **eenvoudig foto's en aanvullende klinische informatie kunt toevoegen.**

Deze beelden- samen met extra info over de locatie op het lichaam en andere relevante klinische kenmerken - bieden onze pathologen een **duidelijke meerwaarde** en ondersteunen een accurate interpretatie van uw biopten.

Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u het stappenplan om foto's te uploaden, evenals praktische richtlijnen voor het correcte gebruik van fixatieven binnen de anatomopathologie.
Eenvoudig in gebruik, GDPR-proof en toegankelijk via GSM, laptop en tablet

MyLab

Door artsen gewaardeerd als het meest vooruitstrevende digitaal laboplatform.

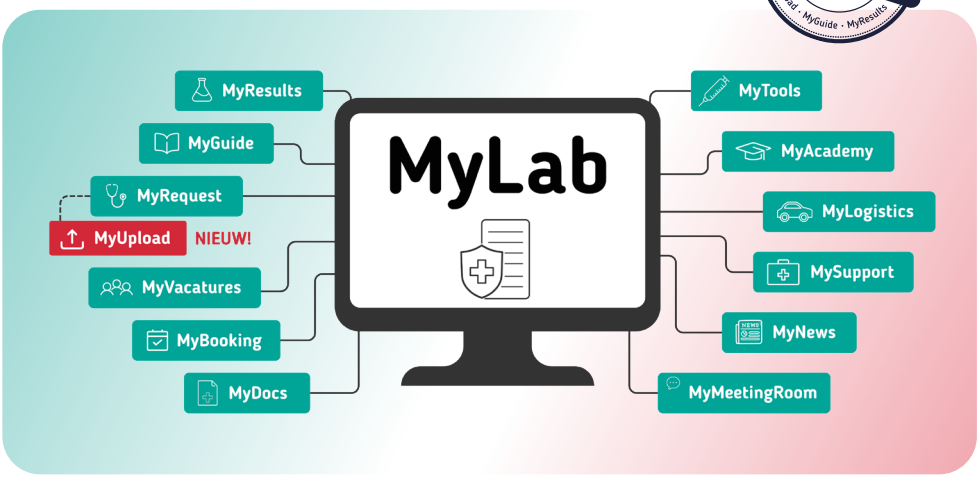

Hoe werkt het?

1



Klik op het 'MyUpload'-icoon rechtsboven in MyRequest.

2

Scan de QR-code om foto's toe te voegen via smartphone/tablet of upload meteen van op uw computer.

3

Op smartphone/tablet: kies of u beelden uploadt uit uw fotobibliotheek of maak nieuwe foto's met de camera.

4

Voeg bij elke foto een notitie toe, verwijder foto's of voeg extra beelden toe. Klik op 'Upload' als u klaar bent.

5

U krijgt een melding dat de bestanden succesvol verstuurd zijn. U mag het venster nu sluiten.

6



In MyResults kan u via het groene paperclipicoontje naast het staalnummer uw geüploade foto's raadplegen. Extra beelden toevoegen kan via 'Acties' en 'Upload'.

Liever een uitgebreide toelichting?

Scan dan eenvoudig de QR-code en bekijk de stap-voor-stap video tutorial van MyUpload. Zo ontdek je alle functies en handige tips om het meeste uit MyUpload te halen!

Richtlijnen fixatieven anatomopathologie

In ons lab gebruiken we formaline voor routine histologie, Michels medium voor immunofluorescentie, en cytologische fixatieven zoals ThinPrep en FineFix voor cytologie. Elk fixatief heeft specifieke indicaties, praktische gebruiksregels en houdbaarheid.

	HISTOLOGIE	
	Indicatie	Praktisch gebruik
Formaline	• Standaard fixatief voor histologische preparaten (stansbiopten, huidresecties) • Geschikt voor immuunhistochemie en de meeste moleculaire testen	• 10% neutraal gebufferde formaline (≈4% formaldehyde) • Weefsel moet binnen 1 uur na excisie in fixatief geplaatst worden • Volume: minimaal 10:1 fixatief/weefsel • Fixatieduur: 6–72 uur, bij voorkeur minstens 8 uur
Michels medium	• Specifiek voor immunofluorescentieonderzoek, vooral bij inflammatoire huidbiopten (bv. Bulleuze huidziekten) • Behoudt antigenen en immuuncomplexen	• Biopten direct in Michels medium plaatsen • Geschikt voor transport bij kamertemperatuur
	CYTOLOGIE	
	Indicatie	Praktisch gebruik
ThinPrep	• Cervixuitstrijkjes en andere cytologische stalen • Optimaliseert celmorfologie en verwijdert storende elementen (bloed, slijm)	• Afnameborstel (cytobrush) in het recipiënt afdraaien volgens richtlijnen • Andere vochten direct in PreservCyt-vloeistof suspenderen • Maakt automatische verwerking tot dunne laagcytologie mogelijk
FineFix	• Urinecytologie (geen lyse van erythrocyten)	• Urine direct in FineFix plaatsen
	Stalen steeds bewaren op kamertemperatuur (18°C - 22°C). De potjes met Michel's medium (zonder staal) dienen koel bewaard te worden (2°C - 8°C). Controleer steeds de vervaldatum.	